




RCP de CALIDAD



Desfibrilación Externa Automática

(SEGÚN RECOMENDACIONES 2015 DEL EUROPEAN RESUSCITATION COUNCIL)

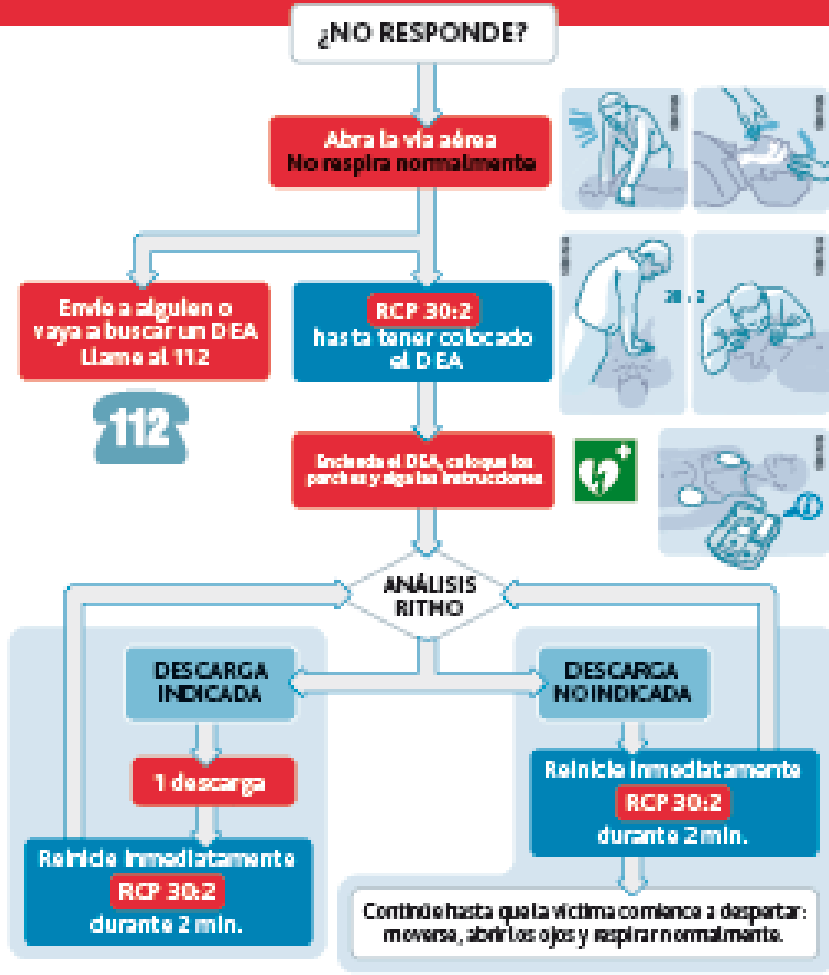

- ❑ Compresiones de calidad
 - ❑ Frecuencia: 100 - 120 min
 - ❑ Profundidad: 5 - 6 cm
 - ❑ Tiempo: Compresión = Relajación
- ❑ Minimizar tiempo sin compresiones torácicas
- ❑ Cambiar de reanimador cada 2 minutos
- ❑ Respiraciones de rescate < 10 sg